
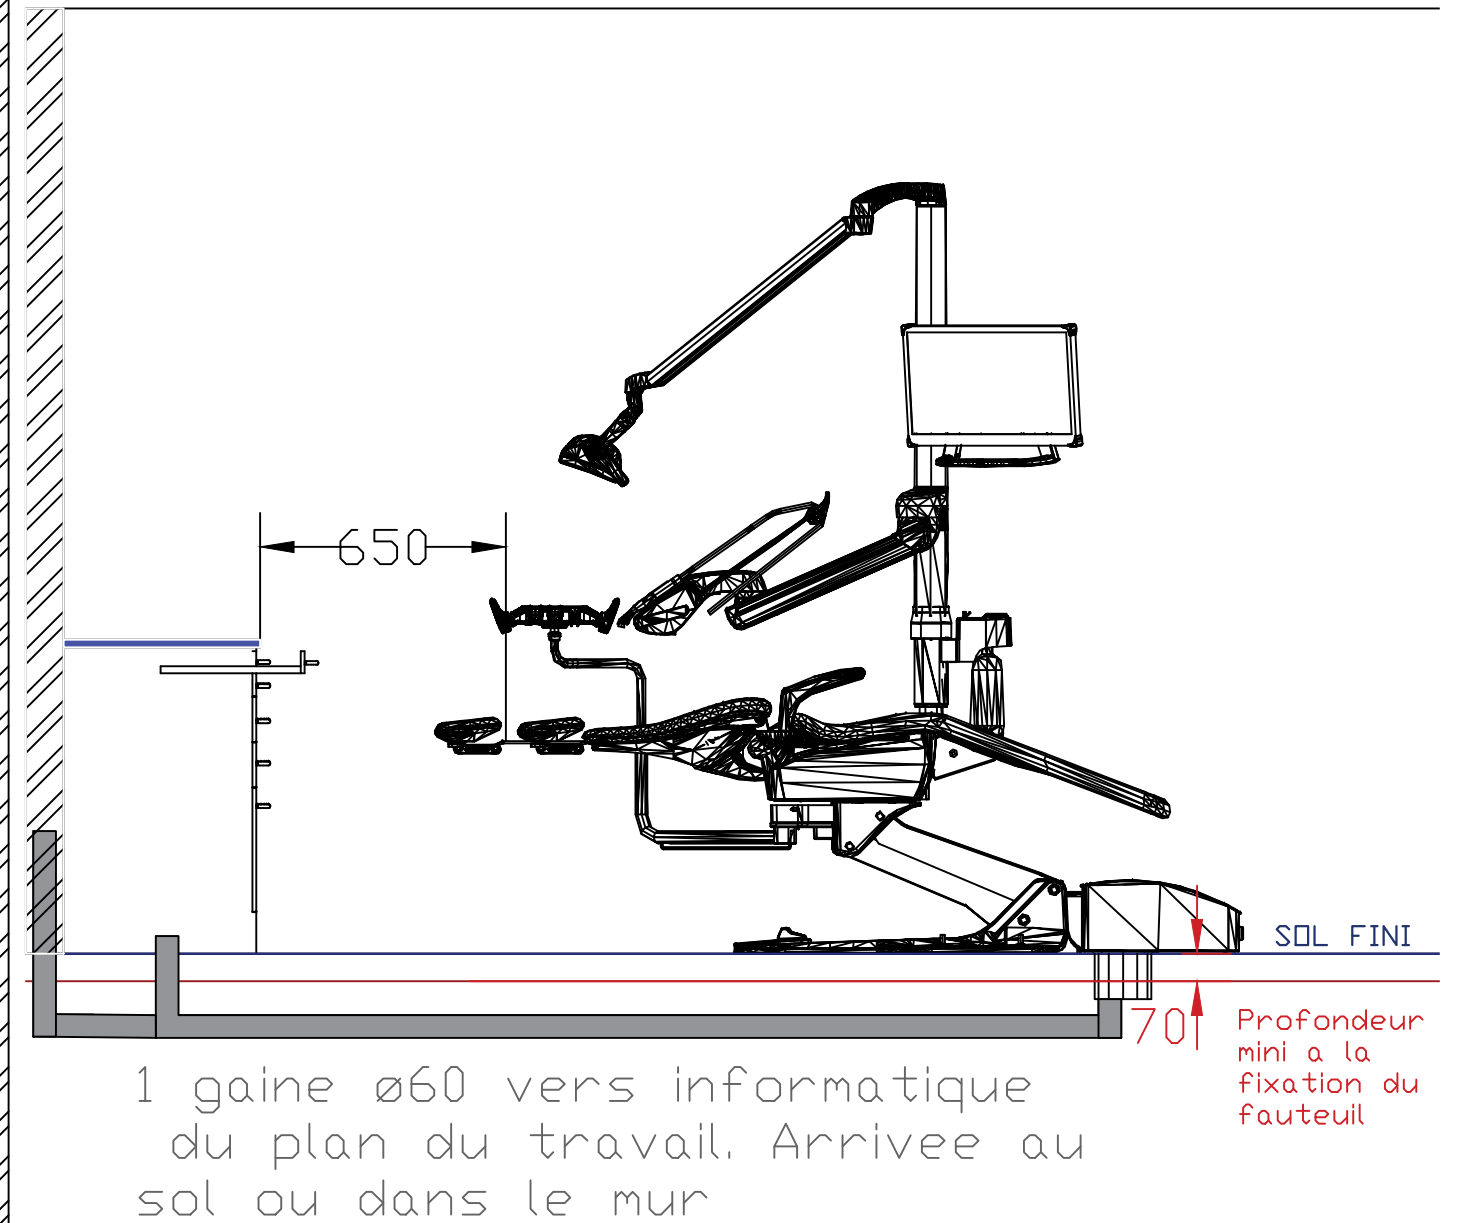
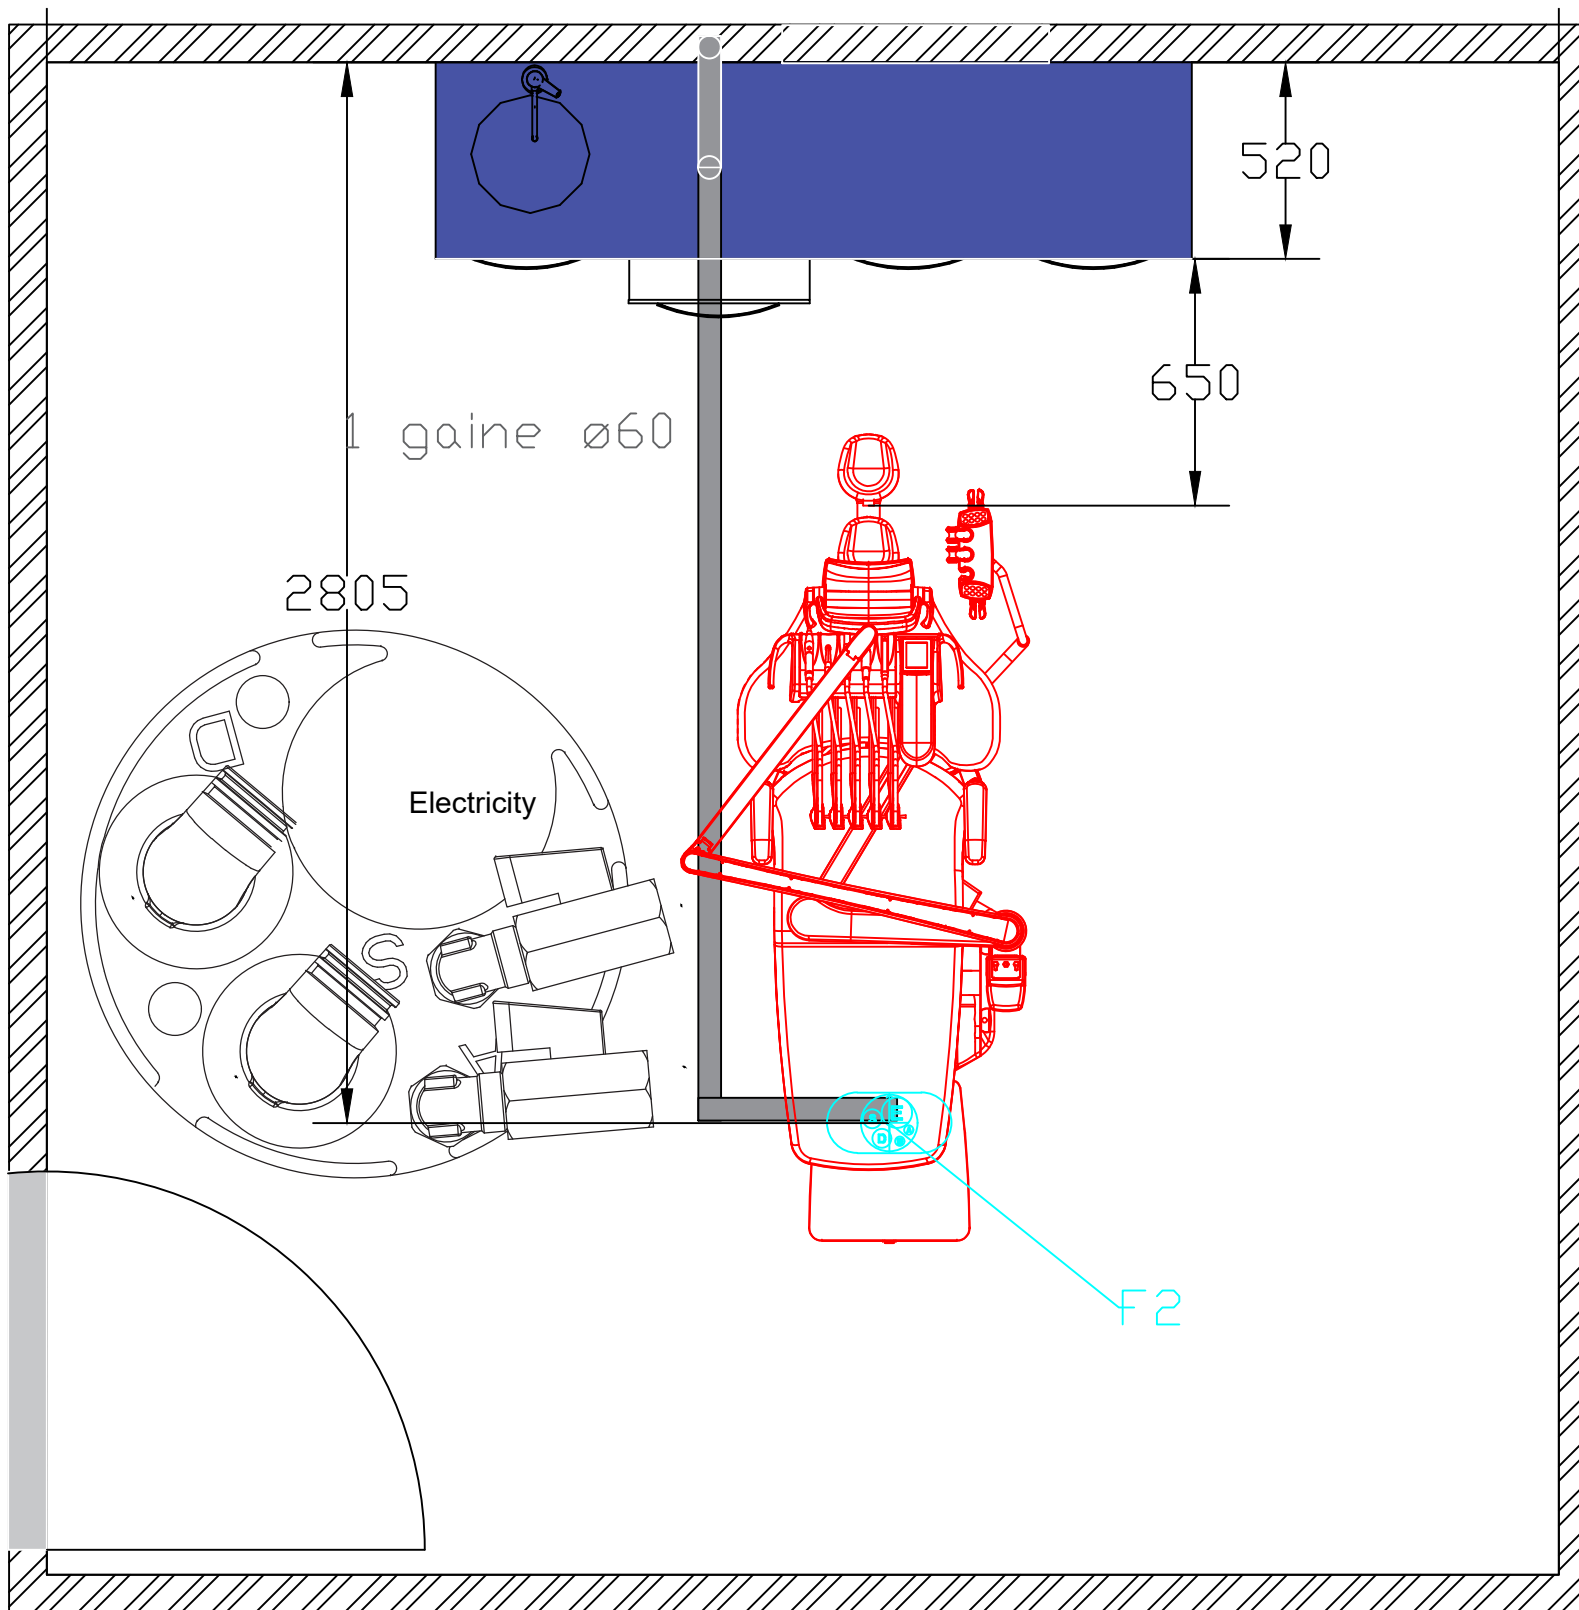



1 gaine ø60 vers informatique
du plan du travail. Arrivee au
sol ou dans le mur


	Société: Jaasp Dantaire 10 Rue Faraday Merignac 33700		Nom: H.METEOUKKI	
	Projet XX-XX		date MAJ: 17/04/2024	
	Désignation FAUTEUIL PLANMECA i5		Format: A3	Echelle: 1:20
	mercredi 17 avril 2024 15:52:21		Date : 28/01/2024	Ref:



	Société: Jaasp Dantaire 10 Rue Faraday Merignac 33700		Nom: H.METEOUKKI	
	Projet XX-XX		date MAJ: 17/04/2024	
	Désignation FAUTEUIL PLANMECA i3		Format: A3	Echelle: 1:20
	mercredi 17 avril 2024 15:52:21		Date : 28/01/2024	Ref:

INFORMATIONS SUR LES ARRIVEES AU PIED DU FAUTEUIL

Arrivée d'eau froide PE ou CU 10/12 vanne ¼ de T (raccord Male 3/8) maxi 6 cm au-dessus du sol fini
Arrivée air comprimé PE ou CU 10/12 vanne ¼ T (raccord male 3/8) maxi 6 cm au-dessusdu sol fini

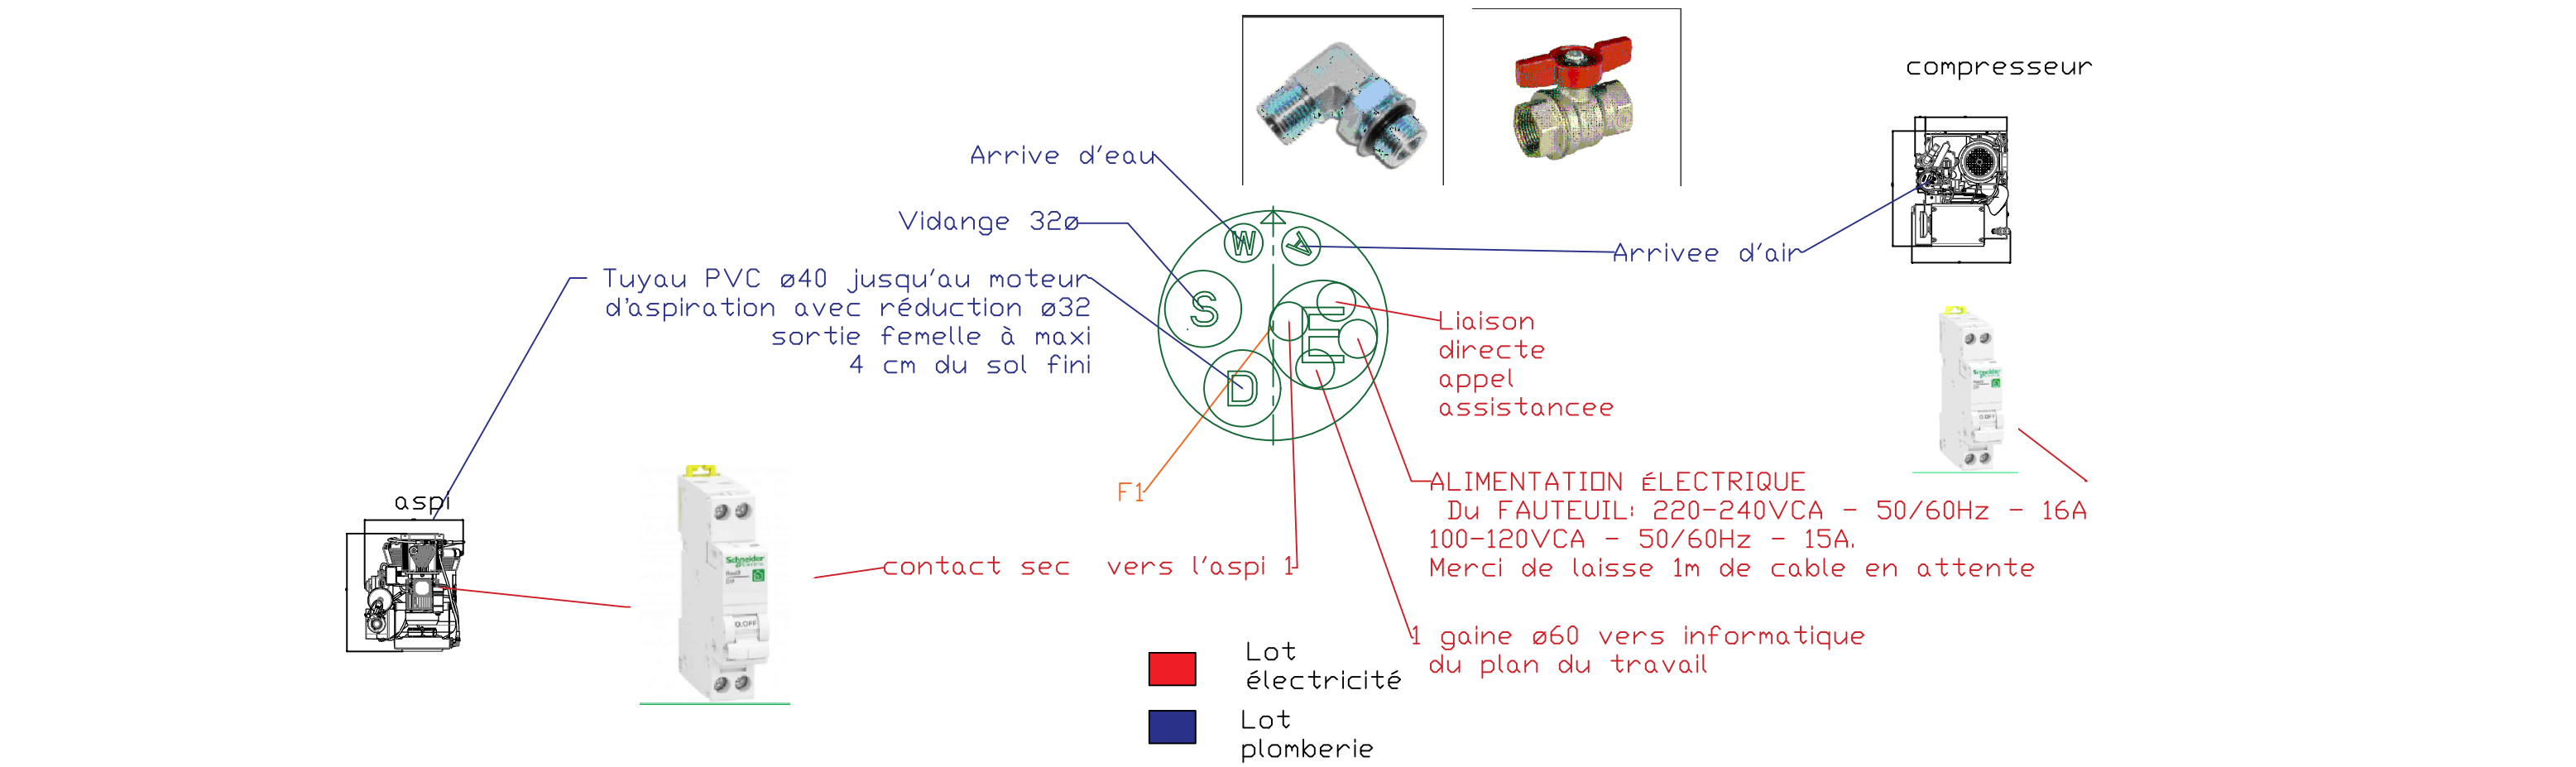

22																															
Version fichier 04/01/2023				EAUX & EAUX USEES						VIDE		AIR		ÉLECTRICITÉ						COMMUNICATION				DIVERS						DossierFichiers	
				Eau Froide		Eau Chaude		Eaux Usées		Aspiration		Air		220V		380 V TRI		RJ45		AUTRE		Div1		Div2		Div3		Schéma d'installation		Date MAJ Plan	
ID	Model	Famille	Firme	EF	EF Pos	EC	EC Pos	EU	EU Pos	Aspiration	Asp Pos	Air	Air Pos	220V	220V Pos	220V	TRI	380 V TRI	Pos	RJ 45	pos	Spécifique	Pos	Div1 Spec	Div 1 pos	Div2 Spec	Div 2 pos	Div3 Spec	Div 3 pos		
F2	COMPACT i3	FAUTEUIL	PLANMECA	vanne papillon 12/17 mâle	Ras de sol			PVC Diam 32 bouchonnée	Non siphonnée ras de sol	PVC Diam 40 vers moteur (M) aspiration sans coude a 90°	ras de sol	Vanne papillon 12/17" Male, Tuyau 10 bars	ras de sol	3x G1,5 30m courbe D	Ligne directe 60 cm de cable en attente au sol	1,0 KW				1	Ligne directe vers informatique (la baie)	Gaine Diam 40 lisse vers arriere meuble du cabinet PO1	ras de sol	Cable téléphonique 2 paires pour appel assistante ; ouverture de porte,,etc.,	60 cm câble en attente	Liaison 1x 3G1,5 avec point M moteur d'aspiration	60 cm câble en attente			PlanMeca i3.pdf Pas de position imposée des différentes réservation. Respecter la taille et la forme de l'ouverture.	04/01/23
F3	Compact i5	FAUTEUIL	PLANMECA	vanne papillon 12/17 Male	Ras de sol			PVC Diam 32	Non siphonnée ras de sol	PVC Diam 40 vers moteur (M) aspiration sans coude a 90°	ras de sol	Vanne papillon 12/17" Male, Tuyau 10 bars	ras de sol	3x G1,5 30mA Courbe D	Ligne directe 60 cm de cable en attente au sol	1,3 KW				1	Ligne directe vers informatique (la baie)	Gaine Diam 40 lisse vers informatique (PC de salle)	ras de sol	Cable téléphonique 2 paires pour appel assistante ; ouverture de porte,,etc.,	60 cm câble en attente	Liaison 1x 3G1,5 avec point M moteur d'aspiration	60 cm câble en attente			PlanMeca i5.pdf A créer par JF Pas de position imposée des différentes réservation. Respecter le positionnement du Diam 150	

	Société:	Jaasp Dantaire 10 Rue Faraday Merignac 33700		Nom: H.METEOUKKI	
	Projet	XX-XX		date MAJ: 17/04/2024	
	Désignation	NOMENCLATURE i3 ET i5		Format: A3	Echelle: XX
		mercredi 17 avril 2024 15:52:21		Date : 28/01/2024	Ref: