


# CONTROLES DES SORBONNES DE LABORATOIRE

Document transmis à titre informatif


Les conditions de conformité seront précisées pour chaque intervention

## Contrôle de type XP X-15 203 : Contrôle de type 1

Qualification  
/ Réception  
XP-X 15-203  
Contrôle 1

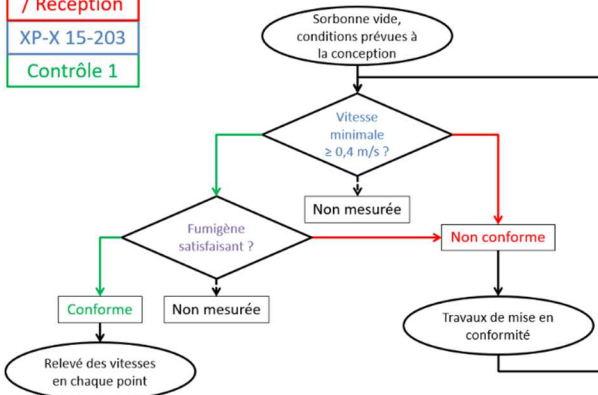


Contrôle  
périodique  
XP-X 15-203  
Contrôle 1

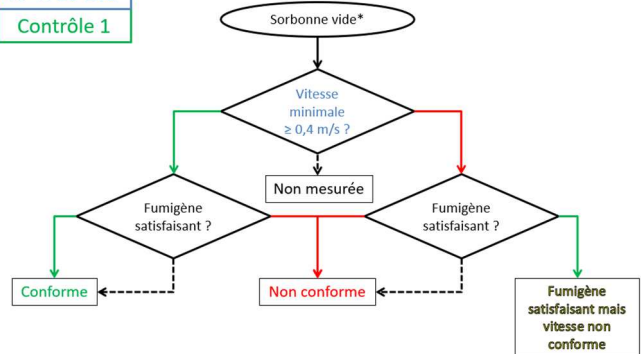


## Contrôle de type NF EN 14175 : Contrôles de types 2 et 3

Qualification  
/ Réception  
NF EN 14175  
Contrôle 2

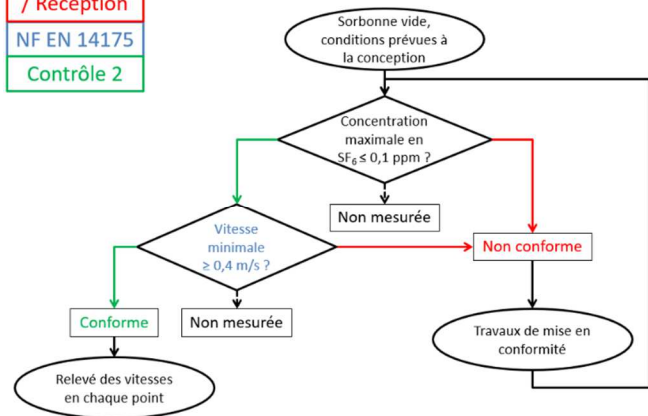


Contrôle  
périodique  
NF EN 14175  
Contrôle 3

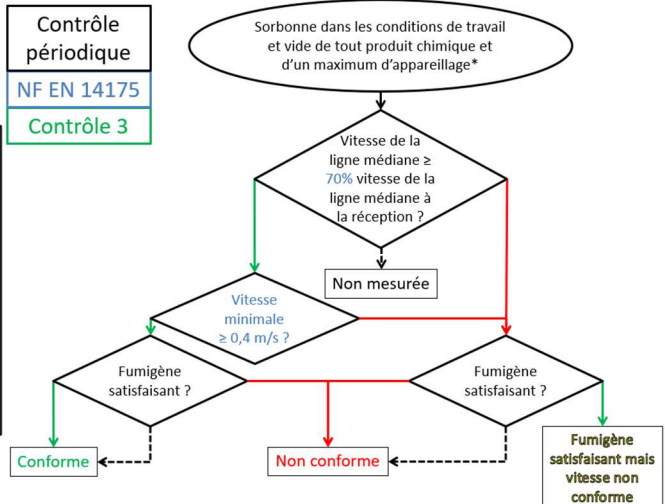


## Contrôle de type 'bas débit' : Contrôle de type 4

Qualification  
/ Réception  
Bas débit  
Contrôle 4

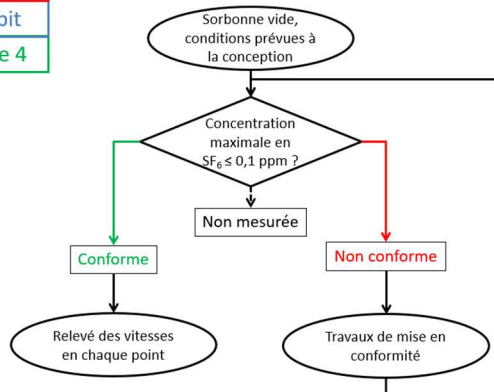

Contrôle  
périodique  
Bas débit  
Contrôle 4

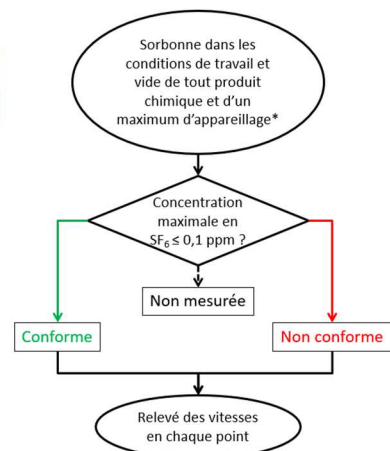

\* : Les éléments et appareillages nécessitant un démontage fastidieux (solidairement fixés au bâti de la sorbonne, barres de fixation...), les équipements en permanence sous une sorbonne ou très volumineux seront maintenus dans les sorbonnes.