

Document délivré à :

IRSN

BP3
13115 St PAUL LEZ DURANCE

Numéro du client : 0312000041C01

Certificat d'Étalonnage
Numéro du Certificat : CE170920-008

Appareil Testé :

Constructeur : FLUKE
Modèle : FL771

N° de Série : 96770025
N° d'Identification : MF117090165
N° d'Identification Client : IR003468
Demande De Service : 170900127

Procédure Utilisée :

FLUKE 771

Version : 1.00

Conditions Climatiques :

Température : 23,00 °C ±2°C

Humidité Relative : 40 % ±10%

Remarques :


Notes :

- La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme d'un fac-similé intégral. Ce certificat est conforme au fascicule de documentation FD X 07-012.

Étalons Utilisés : (Raccordements COFRAC ou équivalent consultable sur demande sauf mention contraire)

Modèle	Description	N° de Série	N° d'Étalonnage	Étalonné le	Echéance
FLUKE 5520A	Calibreur Multifonction / Multifunction Calibrator	9345015	1789520A	18/01/2017	18/01/2018

Votre Certificat d'Étalonnage a été établi par **Richard MERAT**, Technicien.
Délivré à Ste SAVINE, le 20 septembre 2017

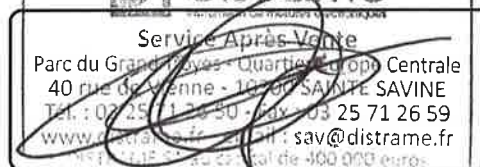

par **Damien MICHEL**
Responsable du Laboratoire

Imprimé le : 20 septembre 2017
Page 1 de 2

Distrame S.A. au capital de 400 000 euros
Parc du Grand Troyes - Quartier Europe Centrale
40 rue de Vienne - 10300 SAINTE SAVINE - France
Tel. +33 (0) 3 25 71 25 83 - Fax +33 (0) 3 25 71 28 98
www.distrame.fr - email : infos@distrame.fr

SIRET : 380 194 019 00077 - R.C.S Troyes B 380 194 019 - TVA FR03380194019 - APE 4669B

Certificat d'Étalonnage - Numéro du Certificat : CE170920-008

Constructeur : FLUKE
Modèle : FL771

N° d'Identification : MF117090165
N° de Série : 96770025

Date : 20 septembre 2017

**Relevé de Mesures**

<u>Description du Test</u>	<u>Valeur Lue</u>	<u>Limite Basse</u>	<u>Limite Haute</u>	<u>Unité</u>	<u>Incertitude</u>	<u>Erreur Absolue</u>	<u>TUR</u>	<u>Résultat</u>
COURANT CONTINU								
ENTRÉE PINCE								
0.00 mA	0.00	-0.05	0.05	mA	5.8e-006A	0.000mA		
-5.00 mA	-4.97	-5.06	-4.94	mA	5.8e-006A	0.030mA		
5.00 mA	5.05	4.94	5.06	mA	5.8e-006A	0.050mA		
-10.00 mA	-9.96	-10.07	-9.93	mA	5.9e-006A	0.040mA		
10.00 mA	10.03	9.93	10.07	mA	5.9e-006A	0.030mA		
-20.00 mA	-19.95	-20.09	-19.91	mA	6.0e-006A	0.050mA		
20.00 mA	19.96	19.91	20.09	mA	6.0e-006A	-0.040mA		
-50.0 mA	-50.0	-51.0	-49.0	mA	5.8e-005A	0.00mA		
50.0 mA	50.0	49.0	51.0	mA	5.8e-005A	0.00mA		
-100.0 mA	-99.9	-101.5	-98.5	mA	5.9e-005A	0.10mA		
100.0 mA	99.9	98.5	101.5	mA	5.9e-005A	-0.10mA		

Fin

(TUR : Rapport d'incertitude entre l'appareil étalonné et l'appareil étalon, si > 4 la valeur n'est pas indiquée.)