



Pôle Achats
5, Allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9

MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES


Marché 2026PFFCORD009

Lot 2


**Fourniture du matériel et prestations associées destinés
à l'agrandissement du Laboratoire de Métrologie de l'IUT
de Figeac**

Annexe technique au CCTP

Agrandissement du laboratoire de Métrologie de l'IUT de Figeac

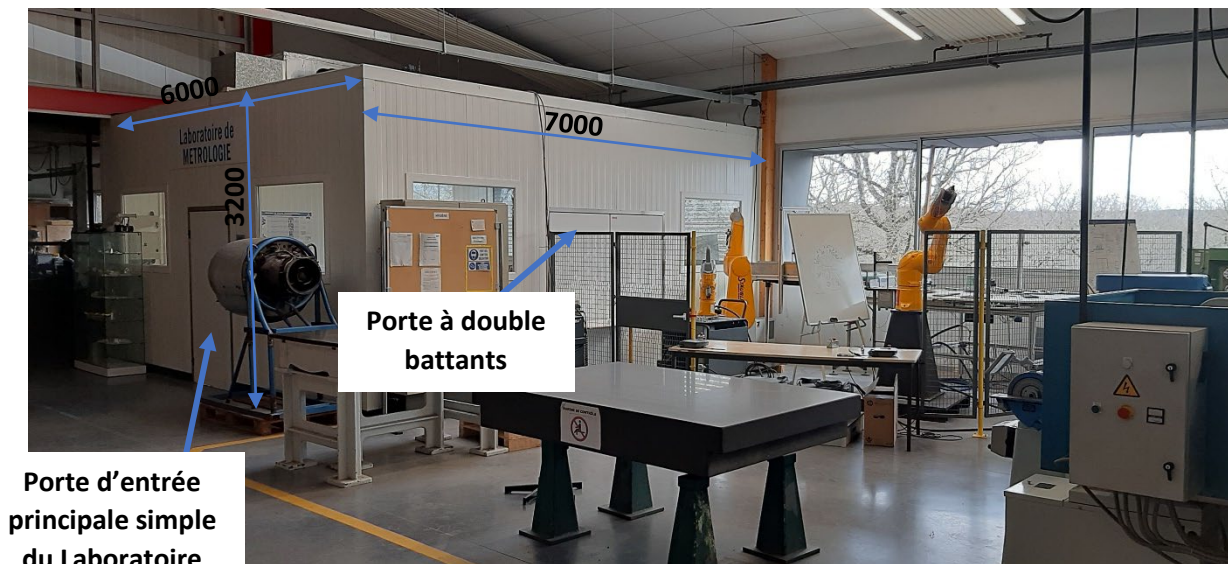


Local de Métrologie actuel et son environnement

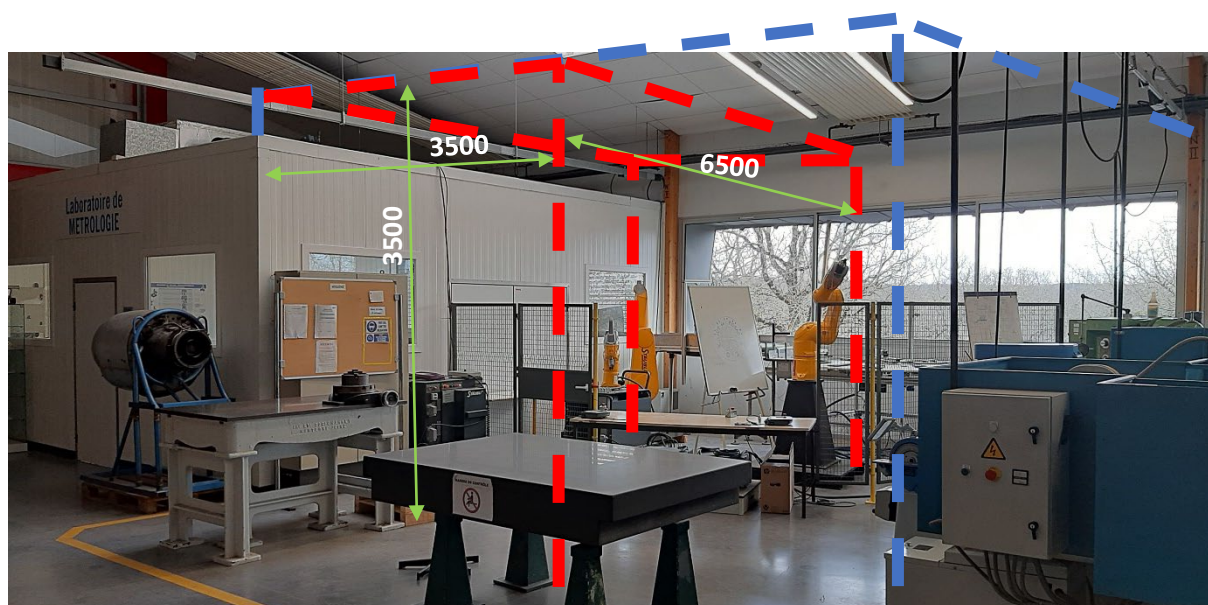


Dimensions et proposition d'agrandissement du local de Métrologie

- — — Zone Maximale d'agrandissement (Longueur utile = 6000mm)
- — — Zone minimale d'agrandissement (Longueur utile = 3500mm)

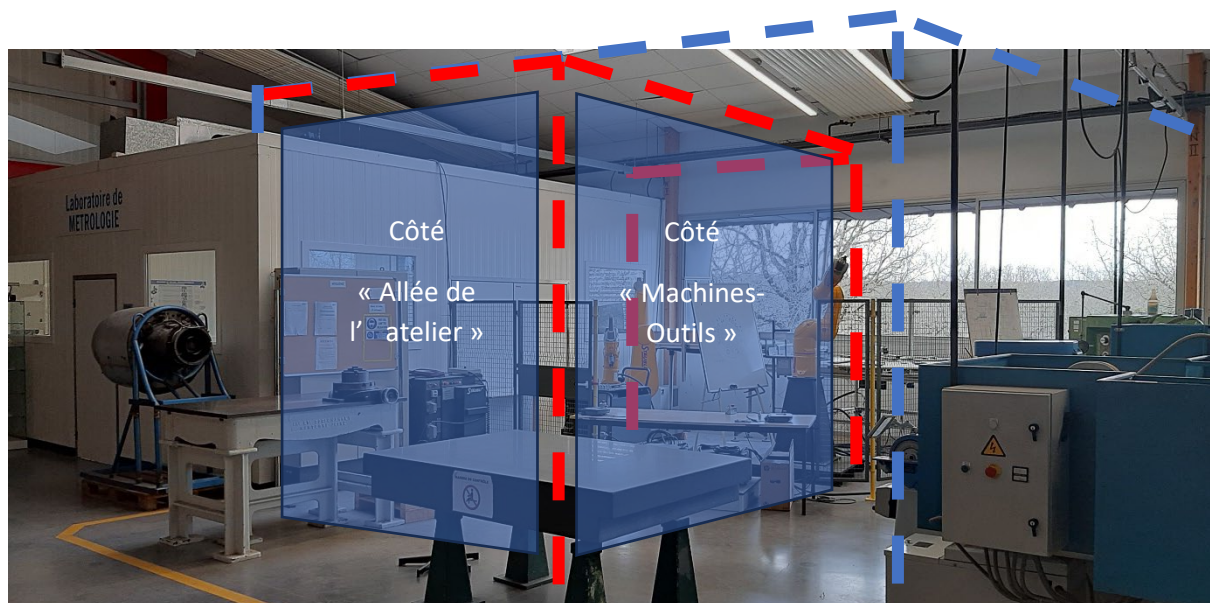

Définition des « Côtés » du local de Métrologie dans le CCTP – 1/2

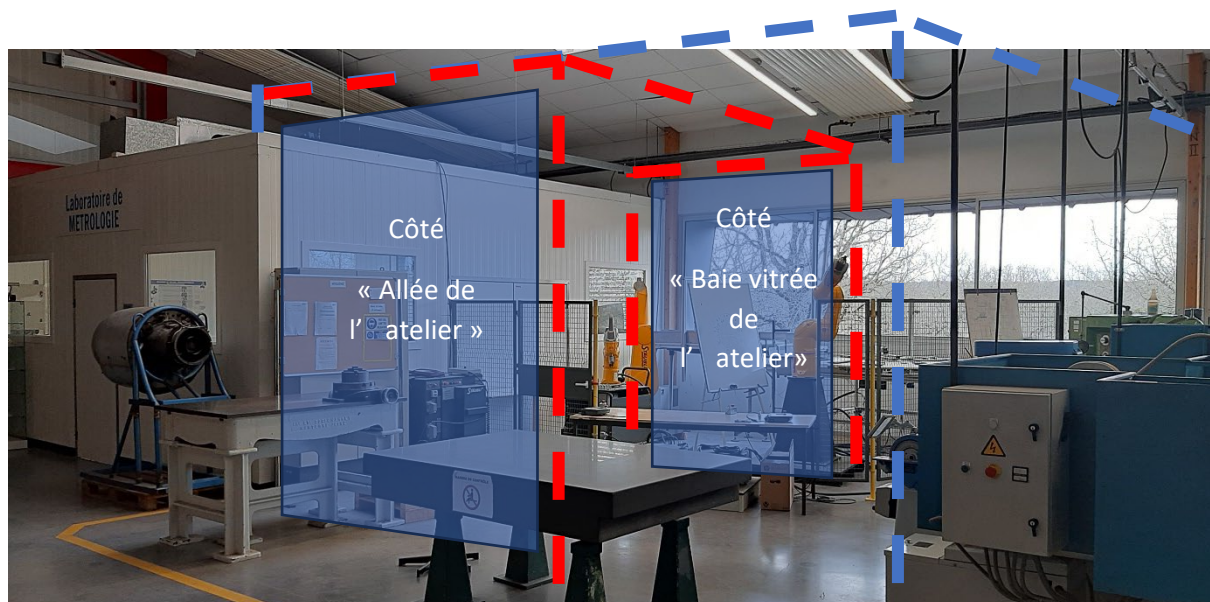

Définition des « Côtés » du local de Métrologie dans le CCTP – 2/2