

UPR/PUL/FAB/DF/FI/091	
Emetteur	EFS Réactifs
Destinataires pour mise en œuvre 	Sites de Production EFS Réactifs de Marseille, Nantes, Reims et Rennes Siège EFS Réactifs (production et ARQ)
Version N° 7	Date de diffusion : 10/03/2026
Date d'application :	Immédiate

Document de Fonctionnement/Fiche

Description des DMDIV CE d'Immuno Hématologie

Modification : 27/02/2026

- En lien avec AME-2024-19: suppression des notices dématérialisées
- Ajout des références pour distribution et codes SAP des étiquettes dédiées
- MAJ des notices des PhenScreen


Chapitre	DMDIV immunohématologie	Ancien nom court	Référence
1	RedQal Group	CQI02	190045 et 276142
	RedQal Group G		242623 et 282201 
2	RedQal IAScreen	CQI03	190046
	RedQal IAScreen G		242624 et 282203 
3	RedQal IAScreen Neg	CQI05	225860
4	RedQal Direct	CQI07	266474 et 276527
	RedQal Direct G		266642 et 282205 
5	RedType 1%	HSF01	235640
6	SERIGRUP A1/B	413659	225865
7	RedType PK Pass 1	OLY03	225902
	RedType PK Pass 2	OLY04	225903
8	RedType PK Lysin	IMM02	225904
9	RedType 5% Pass 1	HSR03	225863
	RedType 5% Pass 2	HSR04	225864
10	RedPan Screen	DNT01	235641
11	SERASCAN 3	410206	225866
12	RedPan ID	INT01	235643
13	RedPan ID-P	ITR01	235644
14	Kit PhenScreen anti-RH8	NA	260476
15	Kit PhenScreen anti-KEL3	NA	260477

Rédacteur	Vérificateur(s)	Approbateur(s)
Sterenn FRABOULET Chargée ARQ et Production	Sandrine BOISSY, Davina BUTROT Sandrine BAILLY Cadres médico-techniques sites de Marseille, Nantes et Reims Franck VERITE RRA site de Rennes Patrice PETITJEAN Responsable Méthodes et Ordonnancement	Cécile PAILLARD  Responsable Nationale d'Activité

1. RedQal Group (CQI02 - 190045, 276142) & RedQal Group G (CQI02 – 242623, 282201)

Dénomination commerciale	Elément	Code SAP	Référence – Version
RedQal Group ou RedQal Group G	1 étiquette blister	277658	CBVA
	1 blister 5 positions	276645	A03338
	4 tubes de prélèvement	230701	367819
	4 étiquettes pour les tubes hématie A1, A2, B et O	277721	TBVA
RedQal Group	1 antigamme	NA édité avec EAntigram	UPR/PUL/FAB/DF/FO/190 - Version 5
	1 étiquette de distribution Diagast (coffrets destinés uniquement à ce distributeur)	276867	Rev1
RedQal Group G	1 antigamme	NA édité avec EAntigram	UPR/PUL/FAB/FO/012 - Version 2
	1 étiquette de distribution Grifols (coffrets destinés uniquement à ce distributeur)	282137	Pas de version


RedQal Group étiqueté

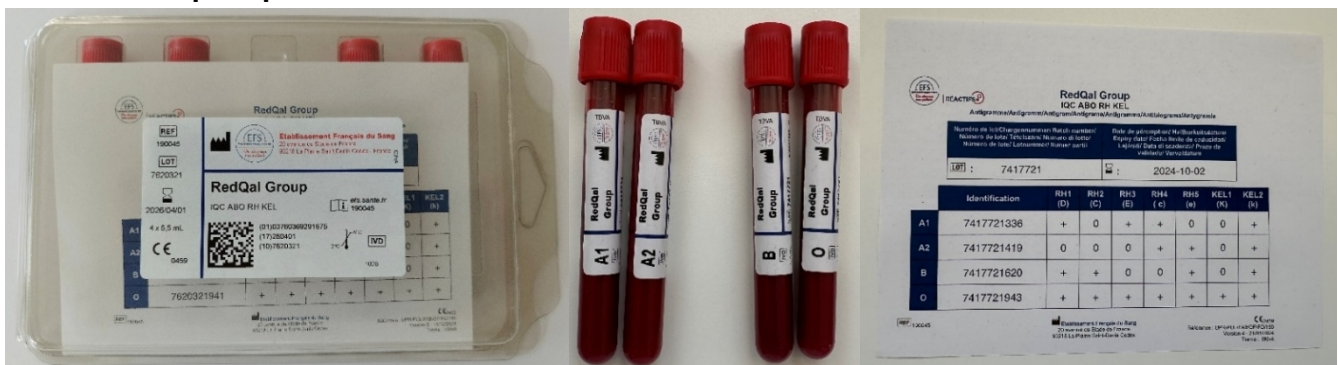

RedQal Group G étiqueté



Coffret RedQal Group pour Distribution

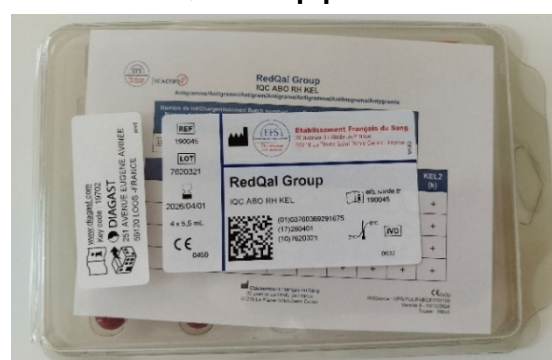


Coffret RedQal Group G pour Distribution




2. RedQal IAScreen (CQI03 - 190046) & RedQal IAScreen G (CQI03 – 242624, 282203)

Dénomination commerciale	Elément	Code SAP	Référence – Version
RedQal IAScreen ou RedQal IAScreen G	1 étiquette blister	277658	CBVA
	1 blister 5 positions	276645	A03338
	4 tubes de prélèvement	230701	367819
	4 étiquettes pour les tubes	277721	TBVA
RedQal IAScreen	1 sérogramme	NA édité avec EAntigram	UPR/PUL/FAB/DF/FO/192 - Version 4
RedQal IAScreen G	1 sérogramme	NA édité avec EAntigram	UPR/PUL/FAB/FO/010 - Version 2
	1 étiquette de distribution Grifols (coffrets destinés uniquement à ce distributeur)	282138	Pas de version

RedQal IAScreen

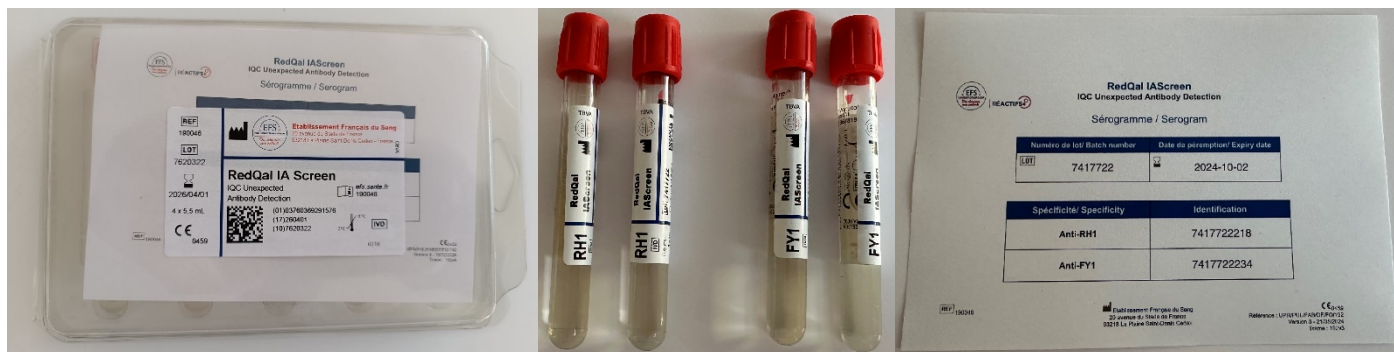

RedQal IAScreen G

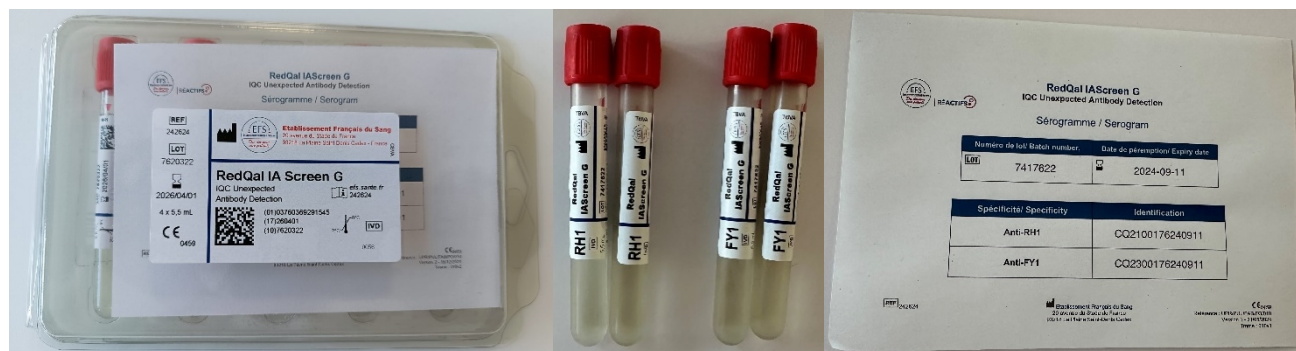

RedQal IAScreen G pour distribution



3. RedQal IAScreen Neg (CQI05 - 225860)

Élément	Code SAP	Référence – Version
1 étiquette boîte	277658	CBVA
1 boîte 2 positions	237421	A03368B
1 cale 2 positions	237422	A03368C
2 tubes de prélèvement	230701	367819
2 étiquettes tube négatif	277721	TBVA



4. RedQal Direct (CQI07 - 266474, 276527) & RedQal Direct G (CQI07 – 266642, 282205)

Il n'existe pas de différence de consommables entre les RedQal Direct et RedQal Direct G. La différence entre les 2 produits réside dans la configuration des code-barres présents sur les tubes. Ils sont édités à partir de EAntigram.

Élément	Code SAP	Référence – Version
1 étiquette boîte	277658	CBVA
1 boîte 2 positions	237421	A03368B
1 cale 2 positions	237422	A03368C
2 tubes de prélèvement	230701	367819
2 étiquettes (1 pour tube IgG et 1 pour tube C3d)	277721	TBVA
1 étiquette de distribution Diagast (coffrets destinés uniquement à ce distributeur)	281804	Rev1
1 étiquette de distribution Grifols (coffrets destinés uniquement à ce distributeur)	282200	Pas de version


Éléments communs



RedQal Direct étiqueté




Coffret RedQal Direct pour distribution

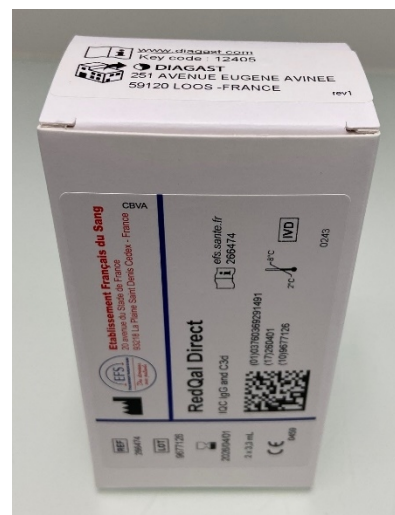

RedQal Direct G étiqueté



Coffret RedQal Direct G pour distribution

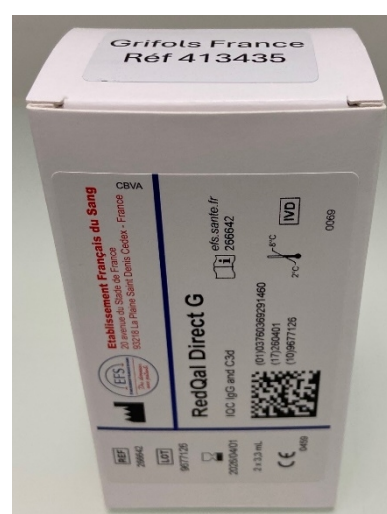


5. RedType 1% (HSF01 - 235640)

Élément	Code SAP	Référence – Version
1 étiquette blister	277658	CBVA
1 blister 2 positions	249504	A03372
2 flacons	146079	1107275
2 bouchons blancs	258427	0851-000001
2 étiquettes pour les flacons : A1 et B	277722	FBVA



6. SERIGRUP A1/B (225865)

Élément	Code SAP	Référence – Version
1 étiquette blister	277658	CBVA
1 blister 2 positions	249504	A03372
2 flacons	146079	1107275
2 bouchons blancs	258427	0851-000001
2 étiquettes pour les flacons : A1 et B	277722	FBVA

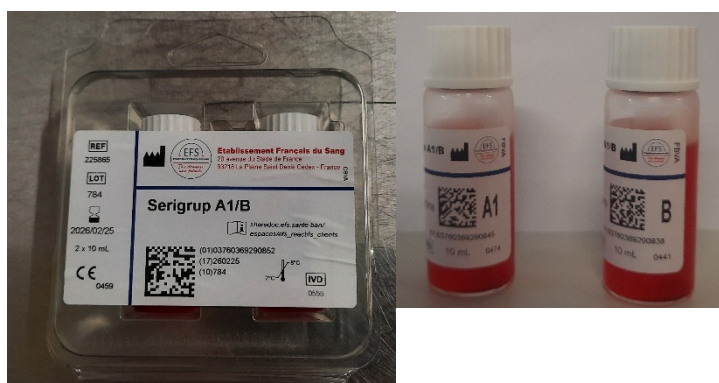

7. RedType PK Pass 1 (OLY03 - 225902) & RedType PK Pass 2 (OLY04 - 225903)

Dénomination commerciale	Elément	Code SAP	Référence – Version
RedType PK Pass 1 ou RedType PK Pass 2	1 boîte 6 positions	227945	A03366B
	1 cale 6 positions	227946	A03366C
	6 flacons	254252	P3673
	6 bouchons	219622	131705
RedType PK Pass 1	1 étiquette boîte	277658	CBVA
	6 étiquettes pour les flacons A1 et B	277725	KBVA
RedType PK Pass 2	1 étiquette boîte	277720	CRVA
	6 étiquettes pour les flacons A1 et B	277726	KRVA

Eléments communs



RedType PK Pass 1 étiqueté




RedType PK Pass 2 étiqueté



8. RedType PK Lysin (IMM02 - 225904)

Élément	Code SAP	Référence – Version
1 étiquette boîte	277658	CBVA
1 boîte 6 positions	227945	A03366B
1 cale 6 positions	227946	A03366C
6 flacons	254252	P3673
6 bouchons	219622	131705
6 étiquettes pour les flacons A1 et B	277725	KBVA

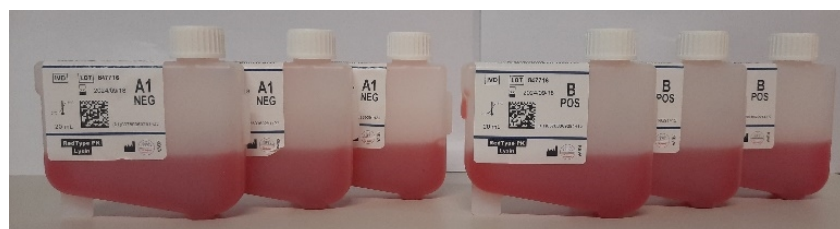


9. RedType 5% Pass 1 (HSR03 - 225863) & RedType 5% Pass 2 (HSR04 - 225864)

Dénomination commerciale	Élément	Code SAP	Référence – Version
RedType 5% Pass 1 ou RedType 5% Pass 2	1 blister 5 positions	276645	A03338
	4 flacons	146079	1107275
RedType 5 Pass 1	1 étiquette blister	277658	CBVA
	4 étiquettes pour les flacons hématie A1, A2, B et O	277722	FBVA
	4 bouchons blancs	258427	0851-000001
RedType 5 Pass 2	1 étiquette blister	277720	CRVA
	4 étiquettes pour les flacons hématie A1, A2, B et O	277723	FRVA
	4 bouchons noirs	258428	0851-000023

RedType 5% Pass 1 étiqueté



RedType 5% Pass 2 étiqueté

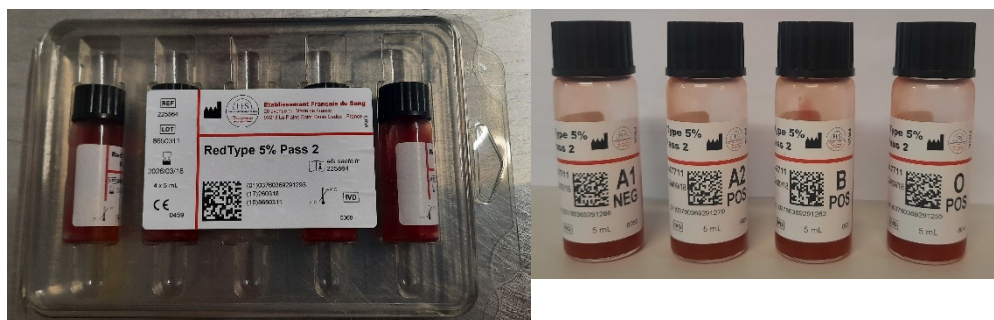

10. RedPan Screen (DNT01 - 235641)

Elément	Code SAP	Référence – Version
1 étiquette blister	277658	CBVA
1 blister 5 positions	276645	A03338
1 antigamme	NA édité avec EAntigram	UPR/PUL/FAB/DF/FO/176 - Version 4
3 flacons	146079	1107275
3 bouchons blancs	258427	0851-000001
3 étiquettes pour les flacons : 1, 2 et 3	277722	FBVA



11. SERASCAN 3 (225866)

Elément	Code SAP	Référence – Version
1 étiquette blister	277658	CBVA
1 blister 5 positions	276645	A03338
1 antigramme	NA édité avec EAntigram	UPR/PUL/FAB/DF/FO/167 - Version 5
3 flacons	146079	1107275
3 bouchons blancs	258427	0851-000001
3 étiquettes pour les flacons : I, II et III	277722	FBVA




12. RedPan ID (INT01 - 235643)

Site de production	Elément	Code SAP	Référence – Version
Nantes et Reims	1 boîte 12 positions	267980	A03350B
	1 cale 12 positions	267981	A03350C
	1 antigramme	NA édité avec EAntigram	UPR/PUL/FAB/DF/FO/177 - Version 4
	11 flacons	146079	1107275
	11 bouchons blancs	258427	0851-000001
Nantes	1 étiquette boîte	277720	CRVA
	11 étiquettes pour les flacons : 1 à 11	277723	FRVA
Reims	1 étiquette boîte	277658	CBVA
	11 étiquettes pour les flacons : 1 à 11	277722	FBVA


Éléments communs



Produit étiqueté pour le site de Nantes

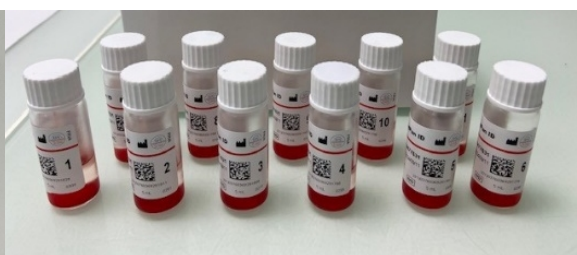


Produit étiqueté pour le site de Reims

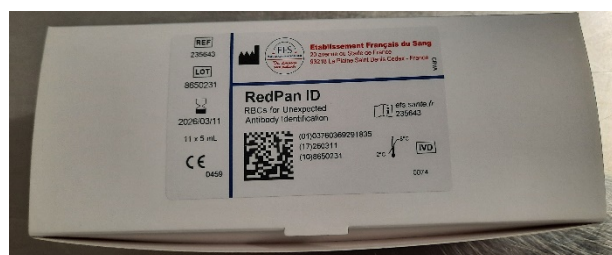


13. RedPan ID-P (ITR01 - 235644) 🟢

Site de production	Élément	Code SAP	Référence – Version
Nantes et Reims	1 boîte 12 positions	267980	A03350B
	1 cale 12 positions	267981	A03350C
	1 antigramme	NA édité avec EAntigram	UPR/PUL/FAB/DF/FO/177 - Version 4
	11 flacons	146079	1107275
	11 bouchons noirs	258428	0851-000023
Nantes	1 étiquette boîte	277720	CRVA
	11 étiquettes pour les flacons : 1 à 11	277723	FRVA
Reims	1 étiquette boîte	277658	CBVA
	11 étiquettes pour les flacons : 1 à 11	277722	FBVA

Éléments communs (pour la boîte, voir éléments spécifiques de chaque site)

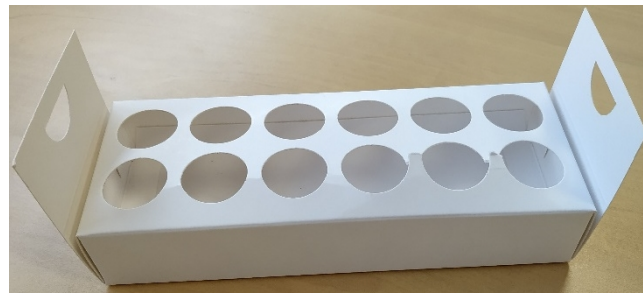

Produit étiqueté pour le site de Nantes

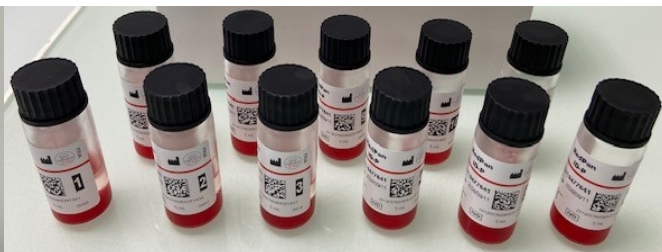

Produit étiqueté pour le site de Reims



14. Kit PhenScreen anti-RH8 (260476)

Élément	Code SAP	Référence
1 étiquette coffret	262627	DX - 100 x 70 - EFS (référence interne 180405)
1 boîte 6 positions	227945	A03366B
1 cale 6 positions	227946	A03366C
1 notice	Éditée à partir de Gedeon 	BRE/REN/UPR/PUL/FAB/FI/065 - Version 2 
6 flacons PK	254252	P3673
6 bouchons PK	219622	131705
2 étiquettes pour réactif anti-RH8	262624	PF26124
4 étiquettes pour PhenScreen Control	262624	PF26124



Réactif Control

15. Kit PhenScreen anti-KEL3 (260477)

Élément	Code SAP	Référence
1 étiquette coffret	262627	DX - 100 x 70 - EFS (référence interne 180405)
1 boîte 6 positions	227945	A03366B
1 cale 6 positions	227946	A03366C
1 notice	Éditée à partir de Gedeon 	BRE/REN/UPR/PUL/FAB/FI/065 - Version 2 
6 flacons PK	254252	P3673
6 bouchons PK	219622	131705
2 étiquettes pour réactif anti-KEL3	262624	PF26124
4 étiquettes pour PhenScreen Control	262624	PF26124



Réactif Control